


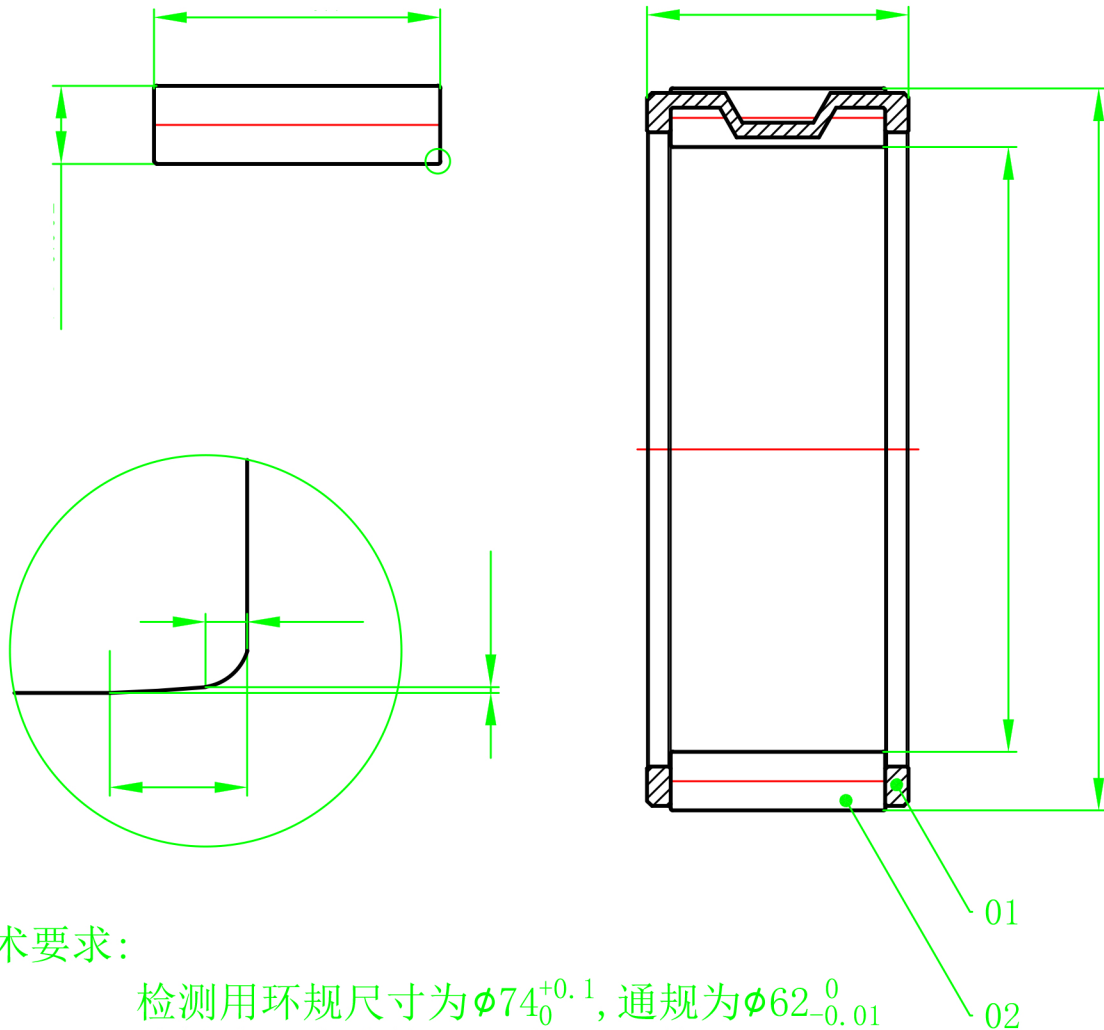

技术要求:

检测用环规尺寸为 $\phi 74^{+0.1}_0$, 通规为 $\phi 62^{0}_{-0.01}$
 滚针为凸度滚针, 两端6mm开始下滑0.01mm
 旋转灵活, 不漏针不卡针
 滚子为G1分组
 外表美观, 无锈蚀无残次

序号	名称	数量	材质	硬度			
01	保持架	1	20	50-55HRC			
02	滚针	26	Gcr15	60-64HRC			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	(签名)	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记	重量比例
审核							
工艺			批准			共 张	第 页